



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 120 - 35
05-12-2017. године

Измене и допуне конкурсне
документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 120-18 од 20.10.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш.

Мења се конкурсна документација за партију 2 у делу 6.1 Образац понуде (Образац 6.1.4-2 Техничка спецификација):

Део 6.1.4 -2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 2 „Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“ (страна 35), по следећем:

1. Мења се за Партију 2 „Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“ у техничкој спецификацији карактеристика број 4 коју понуђено добро мора да поседује и гласи:


	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
4	Opseg podešavanja brzine: 8000±10% до 33000rpm		

Прилог:

-измењена страна конкурсне документације бр. 35

МВН
12

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

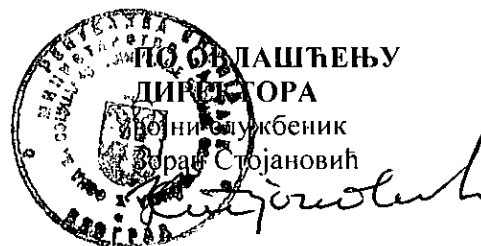

6.1.4-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 2 „Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Izlazna snaga: min. 1500 W		
2	Ulazna snaga: max. 900 W		
3	Opseg volumena mešanja: 100-50 000 ml		
4	Opseg podešavanja brzine: 8 000±10% - 33 000 rpm		
5	Elektronski stabilizator		
6	Masa max. 2 kg		
7	Dimenzije.: 70x70x300 mm (±5 %)		
8	Zaštitni sistem/Klasa zaštite: IP 20/II i više		
9	Zaštita od preopterećenja termalnim senzorom		
10	Bezbednosni prekidač		
11	Alat koji se isporučuje uz uređaj: Univerzalni alat za homogenizaciju, polučvrstih, vlaknastih i tečnih komponenti, Materijal: nerđajući čelik 316L SS i kvalitetniji, Tip statora: Stator 40 mm, Spoljni prečnik statora 40 mm, Tip rotora: za sečenje i mešanje, Dužina alata: min. 300 mm, Opseg volumena za homogenizaciju: 1 000 ml - 20 000 ml.		

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (потпис)