



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 139 - 20

27 DEC 2017 . године

Измену конкурсне
документације,
д о с т а в љ а -

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 139-15 од 20.12.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 38/17 Производи од стакла за фармацеутску и лабораторијску примену.




Мења се конкурсна документација, за партију број 13, у делу 3, у спецификацији добара у колони „Квалитет“:

Део 3 - УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ (страна 9, 19, 20)

1. Мења се Партија број 13 у спецификацији добара у колони „Квалитет“ и гласи:

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis sredstva)	Jed mere	Količina UKUPNO	Kvalitet
13	Zatvarač za pertlovanje boce za krv a 125 ml	kom	12000	Neophodno je da boce za infuzione rastvore „Afnor Plazma“, израђене од стакла прве хидролитичке групе, стандарда ISO 1135-1:1987 (у прилогу цртеж боце) и гумені затварачи стандарда SRPS G.F1.040. или EUROPEAN PHARMACOPEDIA 7 GLAVA 3.2.9 SRPS буду херметички затворени траженим средством, алуминијумским затвараčem за пертловање, помоћу машине за затварање стаклених контејнера „Albatros“ тип TLM 1 B и тако затворене остану интактне у току стерилизације под повишеним притиском на 120 °C.

2. Мења се у делу 3.1. тачка 4. ДОКАЗ: Узорци и испитивање за партију 13 цртеж боце запремине 125ml:

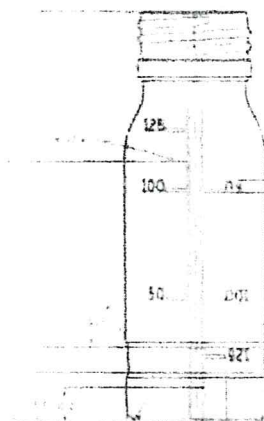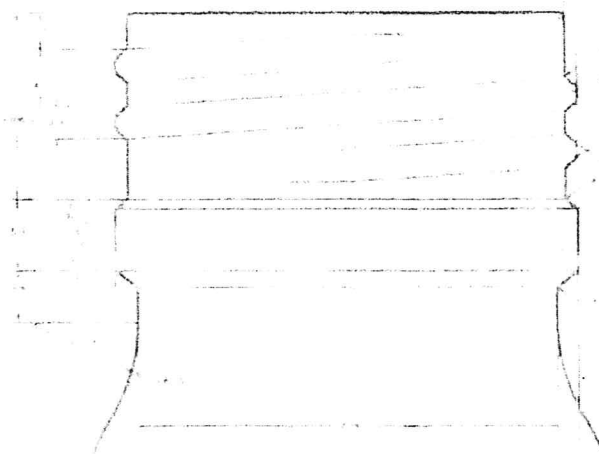

					00466		
Св - М		МЕМ МТН М-А РТ < МНТШ >			00466		
У - Ј		РЕГ УТНМ ЦЕЛ МН ПЛЖ МН Н			15(Г466	7-	
					06455		
— Ј*А	— ОП	М601Р1СА110С			М МОИСС	— С<1	
УАА Шампа и 40 мм 150 Ш-1:1981		М1011/42 ширт.ч			ММТТ		
— *А*ТН1 Ј0 <1.4 Ж1.1К7Ш0		СНПЧ*1*1/54 *— 4 м.			00466		
— *Н1.0ММ *— VА							
					МДСНШЕ 201		
		P1A5MA 125			6747.	# *	

3. Мења се текст на страни 20, за Партију број 13 и гласи:

За партију 13 неопходно је да боце за инфузионе растворе „Afnor Plazma”, израђене од стакла прве хидролитичке групе, стандарда ISO 1135-1:1987 (у прилогу је вртеж боце) и гумени затварач стандарда SRPS G.F1.040. ил EUROPEAN PHARMACOPEIA 7 GLAVA 3.2.9 SRPS буду херметички затворени алуминијумским затварачем за пертловање помоћу машине за затварање стаклених контејнера „Albatros tip TLM 1 B“ и тако затворене остану интактне у току стерилизације под повишеним притиском на 120 °C.

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењене стране конкурсне документације: 9, 19 и 20, и измењена спецификација - табела у Exelu.

МВН




Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.



ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
др Радан Костић

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis sredstva)	Jed mere	Količina VMA	Količina VB NIŠ	Količina UKUPNO	Kvalitet	Medicinsko sredstvo da/ne	Rečenje ALIMSA da/ne	rok isporuke	rok upotrebe
13	Zatvarač za pertlovanje boce za krv a 125 ml	kom	12000		12000	Neophodno je da boce za infuzione rastvore „Afnor Plazma“, izrađene od stakla prve hidrolitičke grupe, standarda ISO 1135-1:1987 (u prilogu crtež boce) i gumeni zatvarači standarda SRPS G.F1.040. ili EUROPEAN PHARMACOEIA 7 GLAVA 3.2.9 SRPS budu hermetički zatvoreni, traženim sredstvom, aluminijumskim zatvaračem za pertlovanje, pomoću mašine za zatvaranje staklenih kontejnera „Albatros“ tip TLM 1 B i tako zatvorene ostanu intaktne u toku sterilizacije pod povišenim pritiskom na 120 °C.	ne	ne	Prva transa, 50% od ukupne količine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora a drugih 50% isporučiti prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika u roku od 7 dana	Neogranicen rok upotrebe

Цртеж боце запремине 125ml

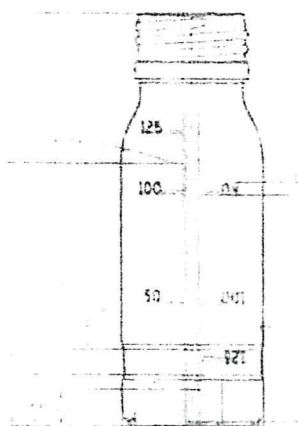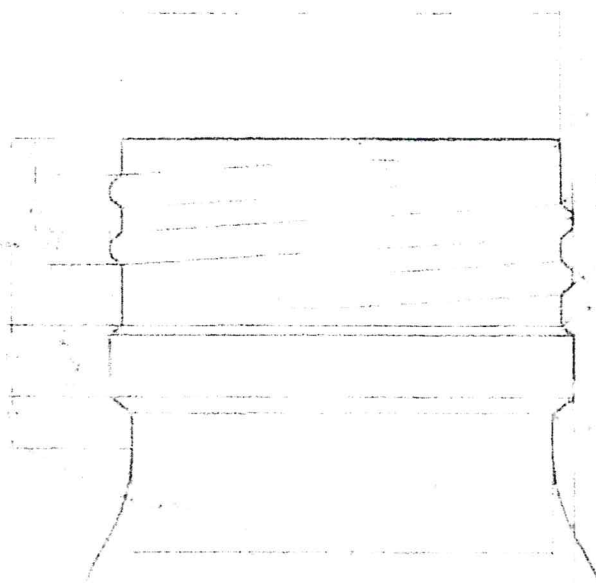

...	00466	
См. см.	0005	
В. В.	15/11/46	7-
...	06455	
...	М. МОСК.	...
УАМ Шалама в 40 км 150Ш-1-1981	Н1011/42 ширт.ч	МАТИ
... ..	СНПЧ*...11/54 *... 4.	00466
... ..		
	ИДСИШЕ 201	
P1A5MA 125	6747.	# *

На отварању понуда у Записник ће се унети да ли је понуђач за сваку партију доставио тражени узорак.

Уколико понуђач не достави узорак, односно по 20 тражених узорака за партије бр. 11, 12, 13 и 14, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Неопходно је да партија 12 - боца за инфузиони раствор стандарда SRPS ISO 719 или EUROPIAN PHARMACOPEIA 7 глава 3.2.1 (у прилогу цртеж боце) и партија 11 – гумени запушачи стандарда SRPS G.F1.050. или EUROPEAN PHARMACOPEIA 7 глава 3.2.9. Ø 38mm, буде херметички затворена траженим алуминијумским затварачем за пертловање – партија 14, помоћу машине за затварање стаклених контејнера „Албатрос“

тип ТЛМ 1 Б и тако затворене остану интактне у току стерилизације под повишеним притиском на 120°.

За партију 13 неопходно је да боце за инфузионе растворе „Afnor Plazma”, израђене од стакла прве хидролитичке групе, стандарда ISO 1135-1:1987 (вртеж боце стр. 19) и гумени затварачи стандарда SRPS G.F1.040. илi EUROPEAN PHARMACOPeIA 7 GLAVA 3.2.9 SRPS буду херметички затворени траженим средством - алуминијумским затварачем за пертловање помоћу машине за затварање стаклених контејнера „Albatros tip TLM 1 B“ и тако затворене остану интактне у току стерилизације под повишеним притиском на 120 °C.

Понуђачи ће након отварања понуда бити обавештени о датуму и времену када ће се вршити испитивање достављених узорака.

Испитивање узорака ће се вршити на Одељењу за фармацеутску технологију Сектора за фармацију ВМА у присуству комисије за предметну јавну набавку и понуђача, а о испитивању узорака сачиниће се записник који ће бити саставни део извештаја о стручној оцени понуда.

3.2. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724.
- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ћинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

3.3. РОК ИСПОРУКЕ

Продавац се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара, у колони „Рок испоруке“ (у делу 3.1 конкурсне документације, за сваку партију).

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност продавца могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.4. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају да поседују квалитет као у спецификацији добара, у колони „Решење АЛИМСа“ и у колони „Квалитет“ у делу 3.1 конкурсне документације, за сваку партију.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.