



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија

Бр. 4407 - 10

21 APR 2016

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА
(кохлеарни и ОРЛ импланти) број 134/2016


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1. На страни 4. Конкурсне документације „Обавезна садржина понуде“, додају се ставови, који гласе:
 - Доказ о испуњавању: СЕ квалитета, о испуњењу техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, да су понуђени производи последње генерације и да испуњавају све техничке карактеристике за понуђена добра из партије 2. (каталог или изјава произвођача);
2. На страни 15. Конкурсне документације, додаје се став, који гласи:
„Минималне техничке карактеристике за вокалне протезе (говорне протезе и пратећи уградни материјал):
 1. Понуђена добра морају бити регистрована у Р.Србији по важећим законима;
 2. Понуђена добра морају испуњавати СЕ услове;
 3. Понуђена добра морају бити у складу са техничким стандардима приступачности за особе са инвалидитетом;
 4. Понуђена добра морају бити производи последње генерације, што се доказује изјавом произвођача о техничким карактеристикама (оригинал или оверена фотокопија);
 5. Понуђач мора обезбедити да уградни материјал који је адекватан и неопходан пацијентима за нормално функционисање протеза;
 6. Уградни материјал мора бити узајамно компатибилан;
 7. Спољни пречник протеза мора бити минимум 22,5 френча. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактеристикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија);
 8. Понуђена добра морају имати најмање 5 различитих дужина. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактеристикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија);
 9. Вентил протеза мора бити увучен и потпуно покривен протезом. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактеристикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија);
 10. За сваку протезу мора бити обезбеђена и четкица за чишћење исте.“

Остале елементи Конкурсне документације „ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 134/2016, остају непромењени.

Ср МС,СБ

ЗМ

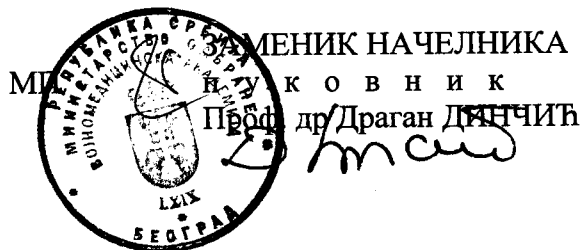

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО