



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3343- 17

10 3 APR 2017

Појашњење у вези са припремањем
понуде, измене и допуне конкурсне
документације, у поступку јавне набавке
Ортопедски материјал, ортопедска
помагала и вештачки зглобови.
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 31.03.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Партија 1 - Da li ćete prihvatiti femoralni stem opciono sa CCD od min 131° za varus kukove do 134°?

Одговор: Предвиђени распон CCD углова од 10 степени (125 – 135 степени) неопходан је ради адекватног оперативног лечења варус деформитета кукова различитог степена. Имајући у виду напред наведено није прихватљив распон CCD углова од само 3 степена (131 до 134 степена).

2.Питање: Партија 1 - Da li ćete prihvatiti acetabularnu kapu opciono veličine od 46-66 mm, sa tri ili više otvora ?

Одговор: У стручној ортопедској литератури и комуникацији „multihole“ ацетабулума подразумевају више од 3 отвора који омогућавају пласирање шrafoва у свим смеровима и равнима. Максимални распон величина ацетабуларне капе је кључан за адекватно извођење комплексне хирургије кука. Распон од само 46 – 66 мм је неприхватљив. Такође, ацетабуларна капа са само 3 отвора не одговара потребама за сигурну фиксацију код диспластичних и коштано инсуфицијентних ацетабулума.

3.Питање: Партија 2 - Da li prihvatate naš predlog da ovu partiju podelite na dve partije, od kojih bi druga u svojoj specifikaciji imala određen broj najmanjih i najvećih veličina (57 I 58 mm) zbog, kako ste kazali "realno očekivanog priliva pacijenata koji će zahtevati što veći raspon veličina za period 2017- 2018 god." ?

Napominjemo da ovako formirana partija ima svoje opravdanje jer smo u našoj analizi ugrađenih parcijalnih biart. proteza u prošloj godini, uočili da niste ugradili ni jednu protezu sa bipolarnom kapom 57mm. Ove podatke dajemo na bazi naših isporučenih proteza u seriji od 40 komada. Ne raspoložemo podacima da li ste u prošloj godini imali i ugrađivali biartikularne proteze od strane drugih proizvođača.

Одговор: Подела партије II на 2 партије није прихватљива, како из просторно техничких разлога, тако и због чињенице да дељењем партија наручилац не добија већи распон од траженог, а на тржишту постоји више регистрованих понуђача који нуде распон ацетабуларне капе 58 и више мм, што је и захтев наручиоца.

4. Питање: Партија 3 - Da li prihvatate da u navedenom nazivu i opisu sredstava dodate "opciono univerzalni stem"; "opciono bez kolara" i "acetabulum opciono protrudirani"?

Одговор: За наручиоца је прихватљиво да се у наведеном називу уз постојећу техничку спецификацију дода и „опционо универзални стем“ и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације. Измена техничке спецификације за ацетабулум не може се прихватити јер се децидно тражи „snap-fit“ антилуксациони ефекат. Опционо протрудирани ацетабулум се по својим карактеристикама разликује од „snap-fit“ ефекта. „Snap-fit“ ефекат је потребан ради обезбеђења додатне механичке стабилности протезе кука, обзиром на индикационо поље за имплантат које подразумева популацију старијег животног доба са повишеним ризиком од луксација.

5. Питање: Партија 4 - Da li prihvatate da u navedenom nazivu i opisu sredstava dopunite "opcino sa tri ili vise otvora" i "opciono bez navigacione hirurgije"?

Napominjemo da je prema našim saznanjima navigaciona hirurgija napuštena, i da se ne koristi unazad 10 godina.

Одговор: У стручној ортопедској литератури и комуникацији „multihole“ ацетабулуми подразумевају више од 3 отвора који омогућавају пласирање шrafoва у свим смеровима и равнима. Ацетабуларна капа са само 3 отвора не одговара потребама за сигурну фиксацију код диспластичних и коштано инсуфицијентних ацетабулума.

Навигациона хирургија у ортопедији није напуштена, него је и даље предмет усавршавања и истраживања по многим чланцима у доступној светској литератури. ВМА као установа терцијарног типа, која је и наставна база Медицинског факултета Универзитета одбране, у обавези је да унапређује и прати научна и стручна достигнућа и допринесе истима, што је и циљ опције да систем поседује могућност навигационе хирургије.

Стога за наручиоца није прихватљива измена техничке спецификације у вези навигационе хирургије.

6. Питање: Партија 5 - Da li prihvatate da u navedenom nazivu i opisu sredstava dopunite sa "opcino sa tri ili vise otvora"?

Одговор: У стручној ортопедској литератури и комуникацији „multihole“ ацетабулуми подразумевају више од 3 отвора који омогућавају пласирање шrafoва у свим смеровима и равнима. Ацетабуларна капа са само 3 отвора не одговара потребама за сигурну фиксацију код диспластичних и коштано инсуфицијентних ацетабулума.

7.Питање: Партија 6 - Da li prihvatate naš predlog da u nazivu i opisu sredstava dopunite “opciono femoralno minimalno 6 veličina, tibijalno minimalno 6 veličina “ I “opciono polietilen aplikovan impaktorom”?

Одговор: За крајњег корисника није прихватљива измена техничке спецификације која подразумева мањи распон величина од траженог.

Тражени имплантат је високо специјализован и стабилност истог првенствено зависи о лигаментарној стабилности и минималној коштаној ресекцији.

Смањење распона не би допринело проширењу техничких карактеристика документације, већ би само захтевало непотребан хируршки компромис.


За наручиоца је прихватљиво да се опционо полиетилен пласира импактором и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

8.Питање: Molimo vas da nam pojasnite šta ste mislili pod “polietilen dvostruko zaključavajući”?

Одговор: Двоструко закључавајући инсерт подразумева додатну стабилност која спречава хабање, а постиже се чињеницом да је полиетилен за нијансу већи од тибјалне компоненте и да постоје браници на инсерту за спречавање антеропостериорних микропокрета.

Прилог: - страна 6 и 7. Конкурсне документације
- образац понуде са структуром цене (прилог 6)

Ср
МК.

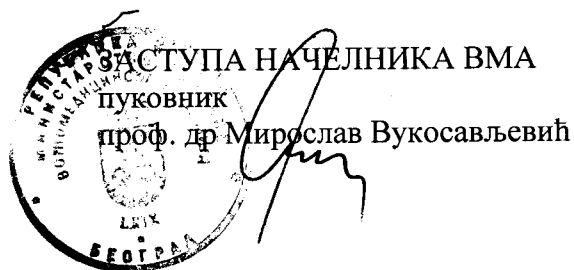

Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

[illegible]

[illegible]