



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6150- 20

2016. године
~~27 JUN~~ 2016

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Ултразвучни уређаји са пратећим
сондама бр. 125/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Партија 1:

Да ли је за наручиоца прихватљива оптимизација за В мод као и скале у доплеру?

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурнсе документације.

2.Питање: Партија 1:

Да ли је за наручиоца прихватљива дубина приказа минимално 30 цм, при чему сваки поједначни орган може да сними са 30 цм дубине.

Одговор: Прихвата се сугестија, биће извршена измена конкурнсе документације.

3.Питање: Партија 1:

Захтевана карактеристика: „Spatial Compound tehnologija za obradu slike koji uključuje Frequency Compound Imaging (FCI).”

Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити две опције које испуњавају овај захтев?


Одговор: Прихвата се сугестија.

4.Питање: Партија 1:

Да ли је за наручиоца прихватљиво уместо матричних сонди понудити Single cristal ili Nanafy lanse технологију која даје униформну слику попут матричне ?

Одговор: Може бити матрична или одговарајућа технологија у складу са захтевима наручиоца.

МК.

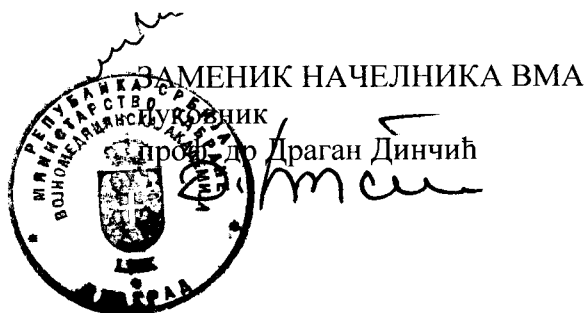

Достављено:

-у омот предмета 6150/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС